

# MedAir

Hava Temizleme ve Dezenfektasyon Cihazları

 selectronik

[www.selectronik.com](http://www.selectronik.com)







# MedAir



## Ne işe yarar?

Her sene mutasyon yolu ile değişime uğrayarak yeni ve daha güçlü bir şekilde sağlığını tehdit eden virüs ve bakterilere karşı tüm kapalı mekanlarda %99,97 mutlak koruma sağlar.



## Ne kadar güçlü?

MedAir cihazları farklı güç kapasitesine sahiptir. MedAir 99, 70m2lik alanı 20 dakikada 25m2lik alanı 6 dakikada dezenfekte etmektedir.



## Farkı nedir?

Bakteri, virüs, akar, küf gibi organizmaların DNA yapısına saniyeler içinde zarar verir. HEPA filtre sayesinde havadaki tüm alerjenleri temizler.



## Çalışırken rahatsızlık verir mi?

MedAir cihazları bulunduğunuz ortamı saniyeler içerisinde temizlerken bunu çok sessiz bir şekilde yapar.

\*MedAir cihazları CE sertifikalıdır.



# MedAir HAVA TEMİZLEME VE DEZENFEKTASYON CİHAZLARI



**MedAir-99**

Tüm kapalı ve risk altında  
olan yaşam alanlarında üst  
düzey koruma sağlar.



**MedAir-13 ELV ve MedAir-13 Bus**

Asansör-Minibüs-Midibüs-  
Otobüslerde etkili koruma sağlar.



**MedAir-74**

Araç-Ofis-Ev  
Küçük mekanlarda büyük  
koruma sağlar.



## MedAir-99 HER ŞEYİYLE EŞSİZ


MedAir Hava Temizleme ve Dezenfektasyon cihazlarımızda bulunan ve tercihinize göre açılıp kapatılabilen UVC Lamba (253,7nm) ile tüm hastanelerin en kritik alanlarında kullanılan ileri teknoloji ürünü HEPA filtre, MedAir'in sahip olduğu avantajlardan sadece ikisi.

MedAir cihazları, 3 Katman ve 6 aşamalı filtreleri ile bakteri, virüs, mayt, akar, Pm 2.5, Pm 10, formaldehit, radon, gaz, polen, küf, mantar ve diğer alerjenleri yok edebilme ve sahip olduğu iyon jeneratörü ile hava ve yaşam kalitenizi bir üst seviyeye taşıyabilme sahiptir.





# MedAir - 99 ÜRÜN YAPISI

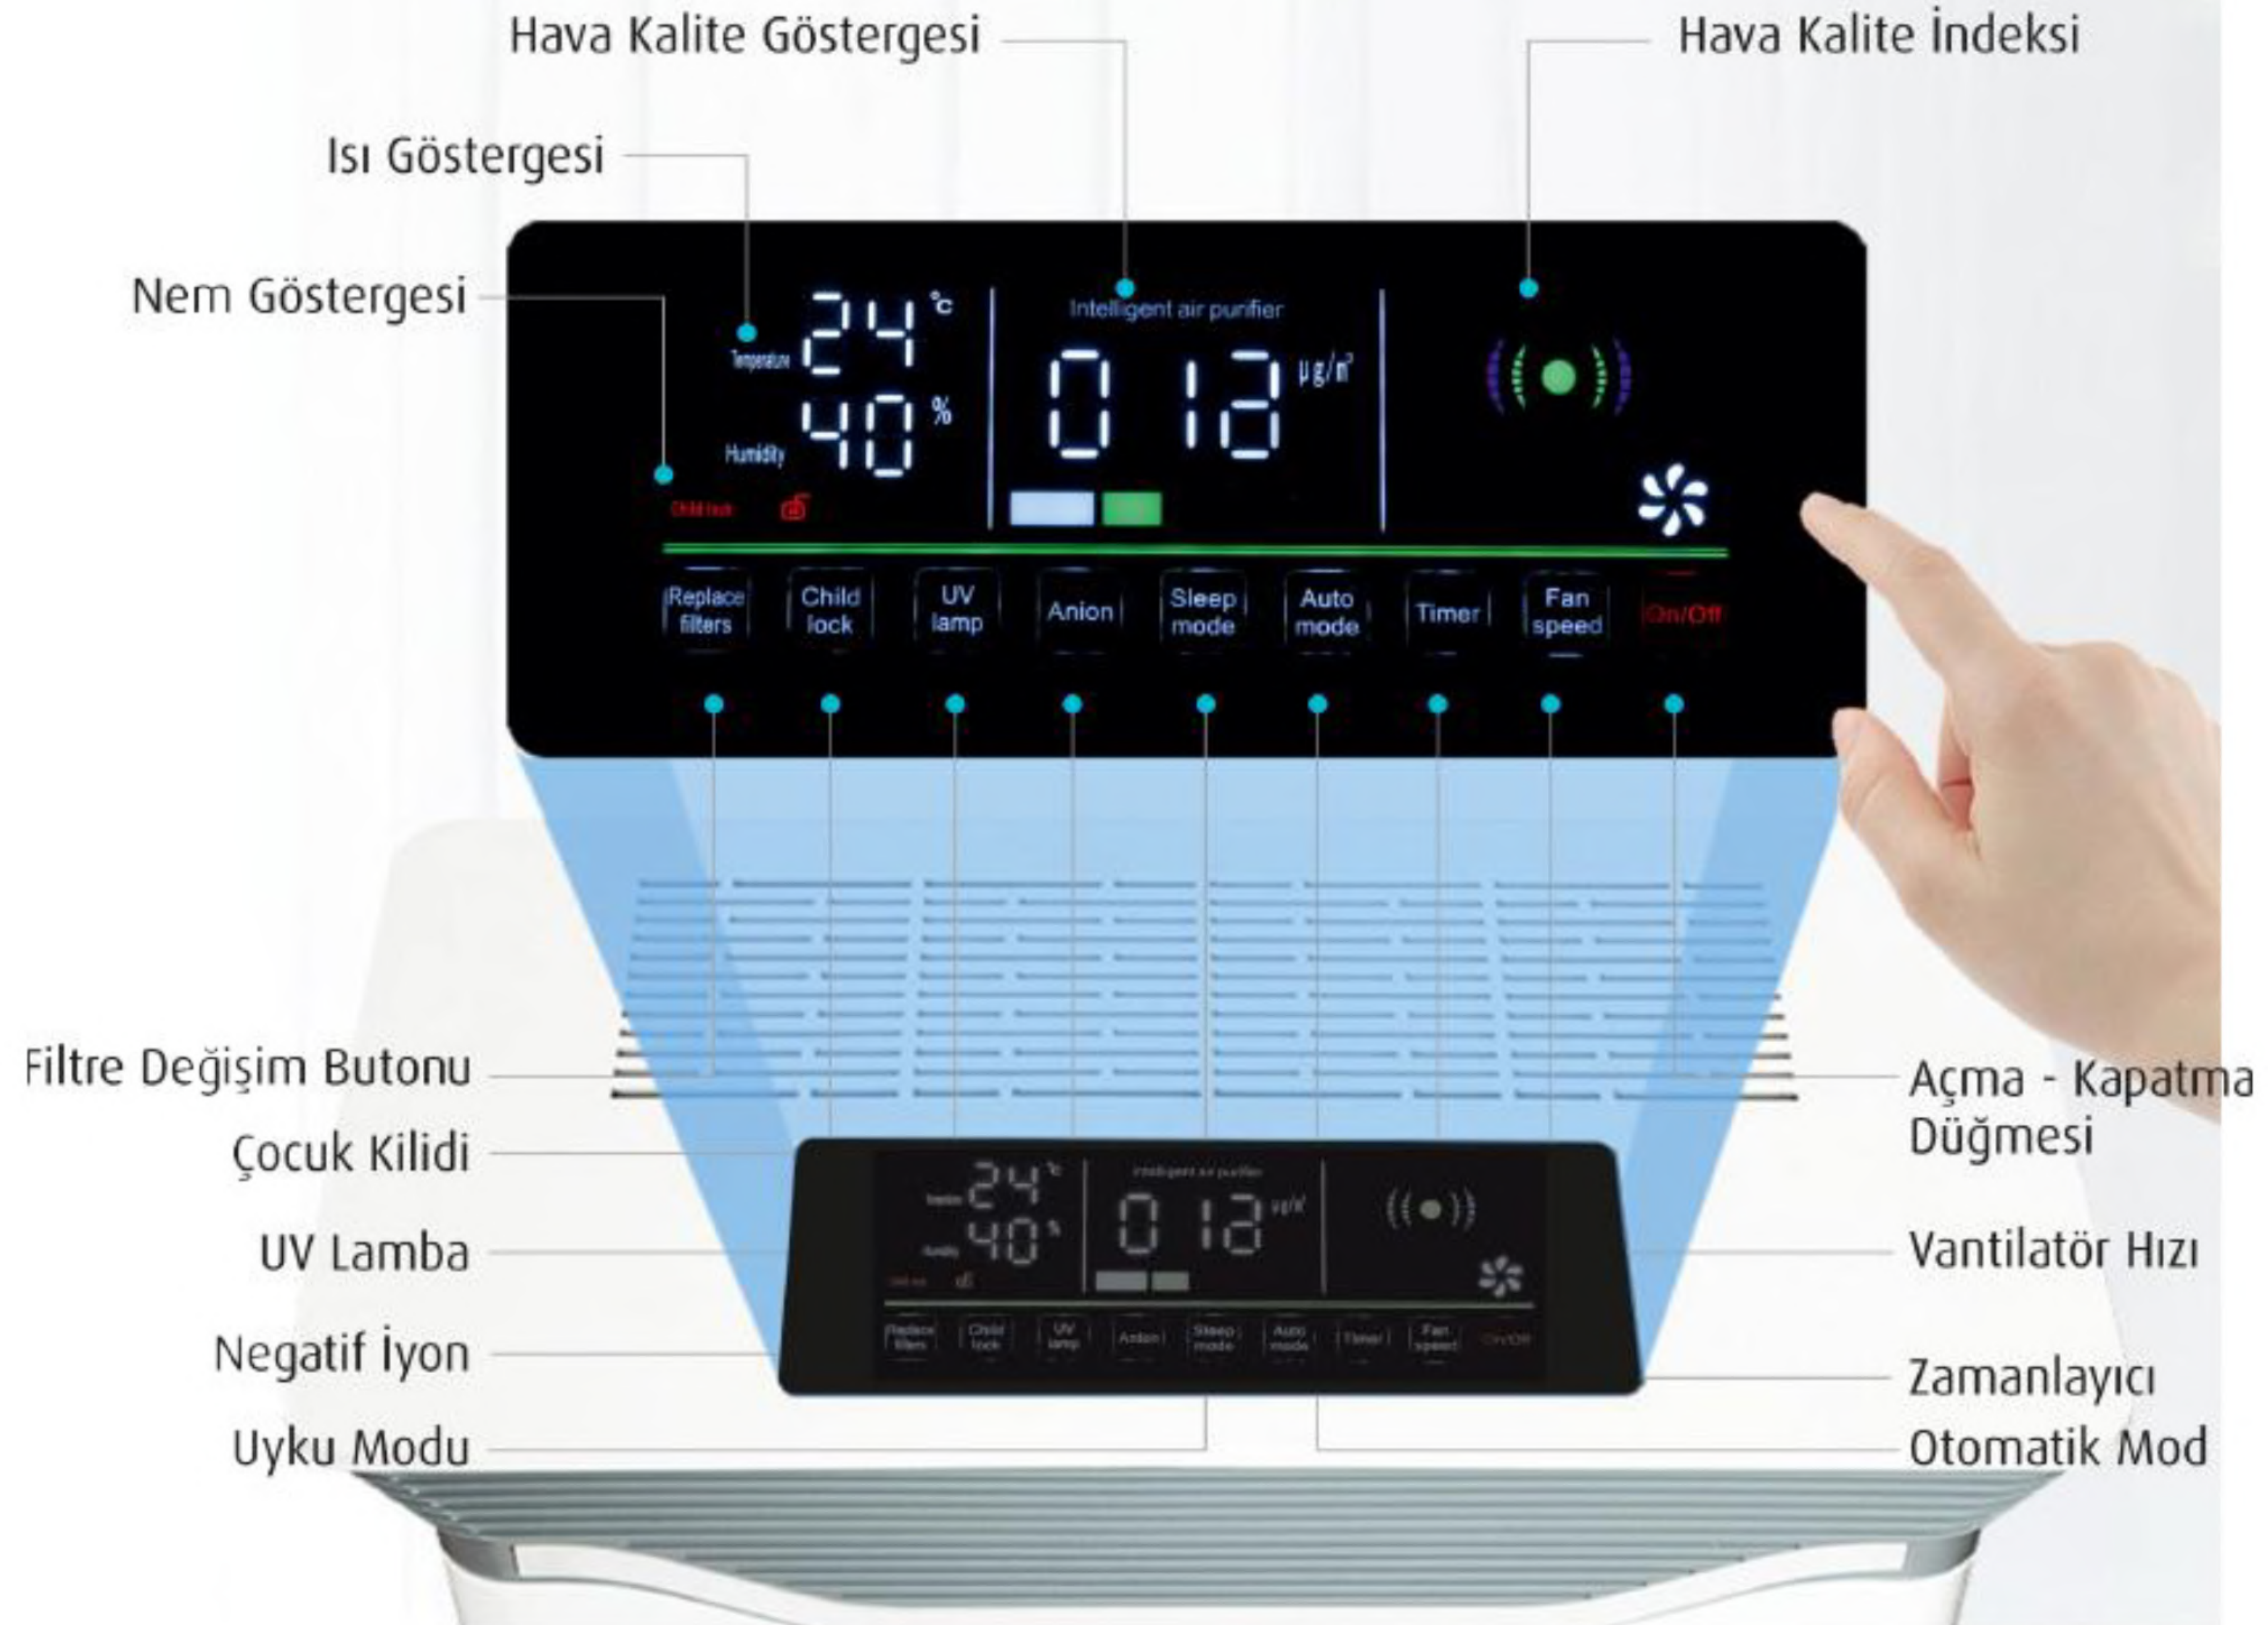






 MedAir

\*MedAir cihazları CE sertifikalıdır.



# KENDİNİZ İÇİN FARK YARATIN

CE sertifikasına sahip MedAir ürünleriyle kendinizi zararlı organizmalardan korumanın yanısıra, iyon jeneratörü sayesinde metabolizmanızı düzenleyen ve bağışıklığınızı güçlendiren deniz, orman ve dağ havasına kavuşacak; daha dinç hissedeceksiniz.

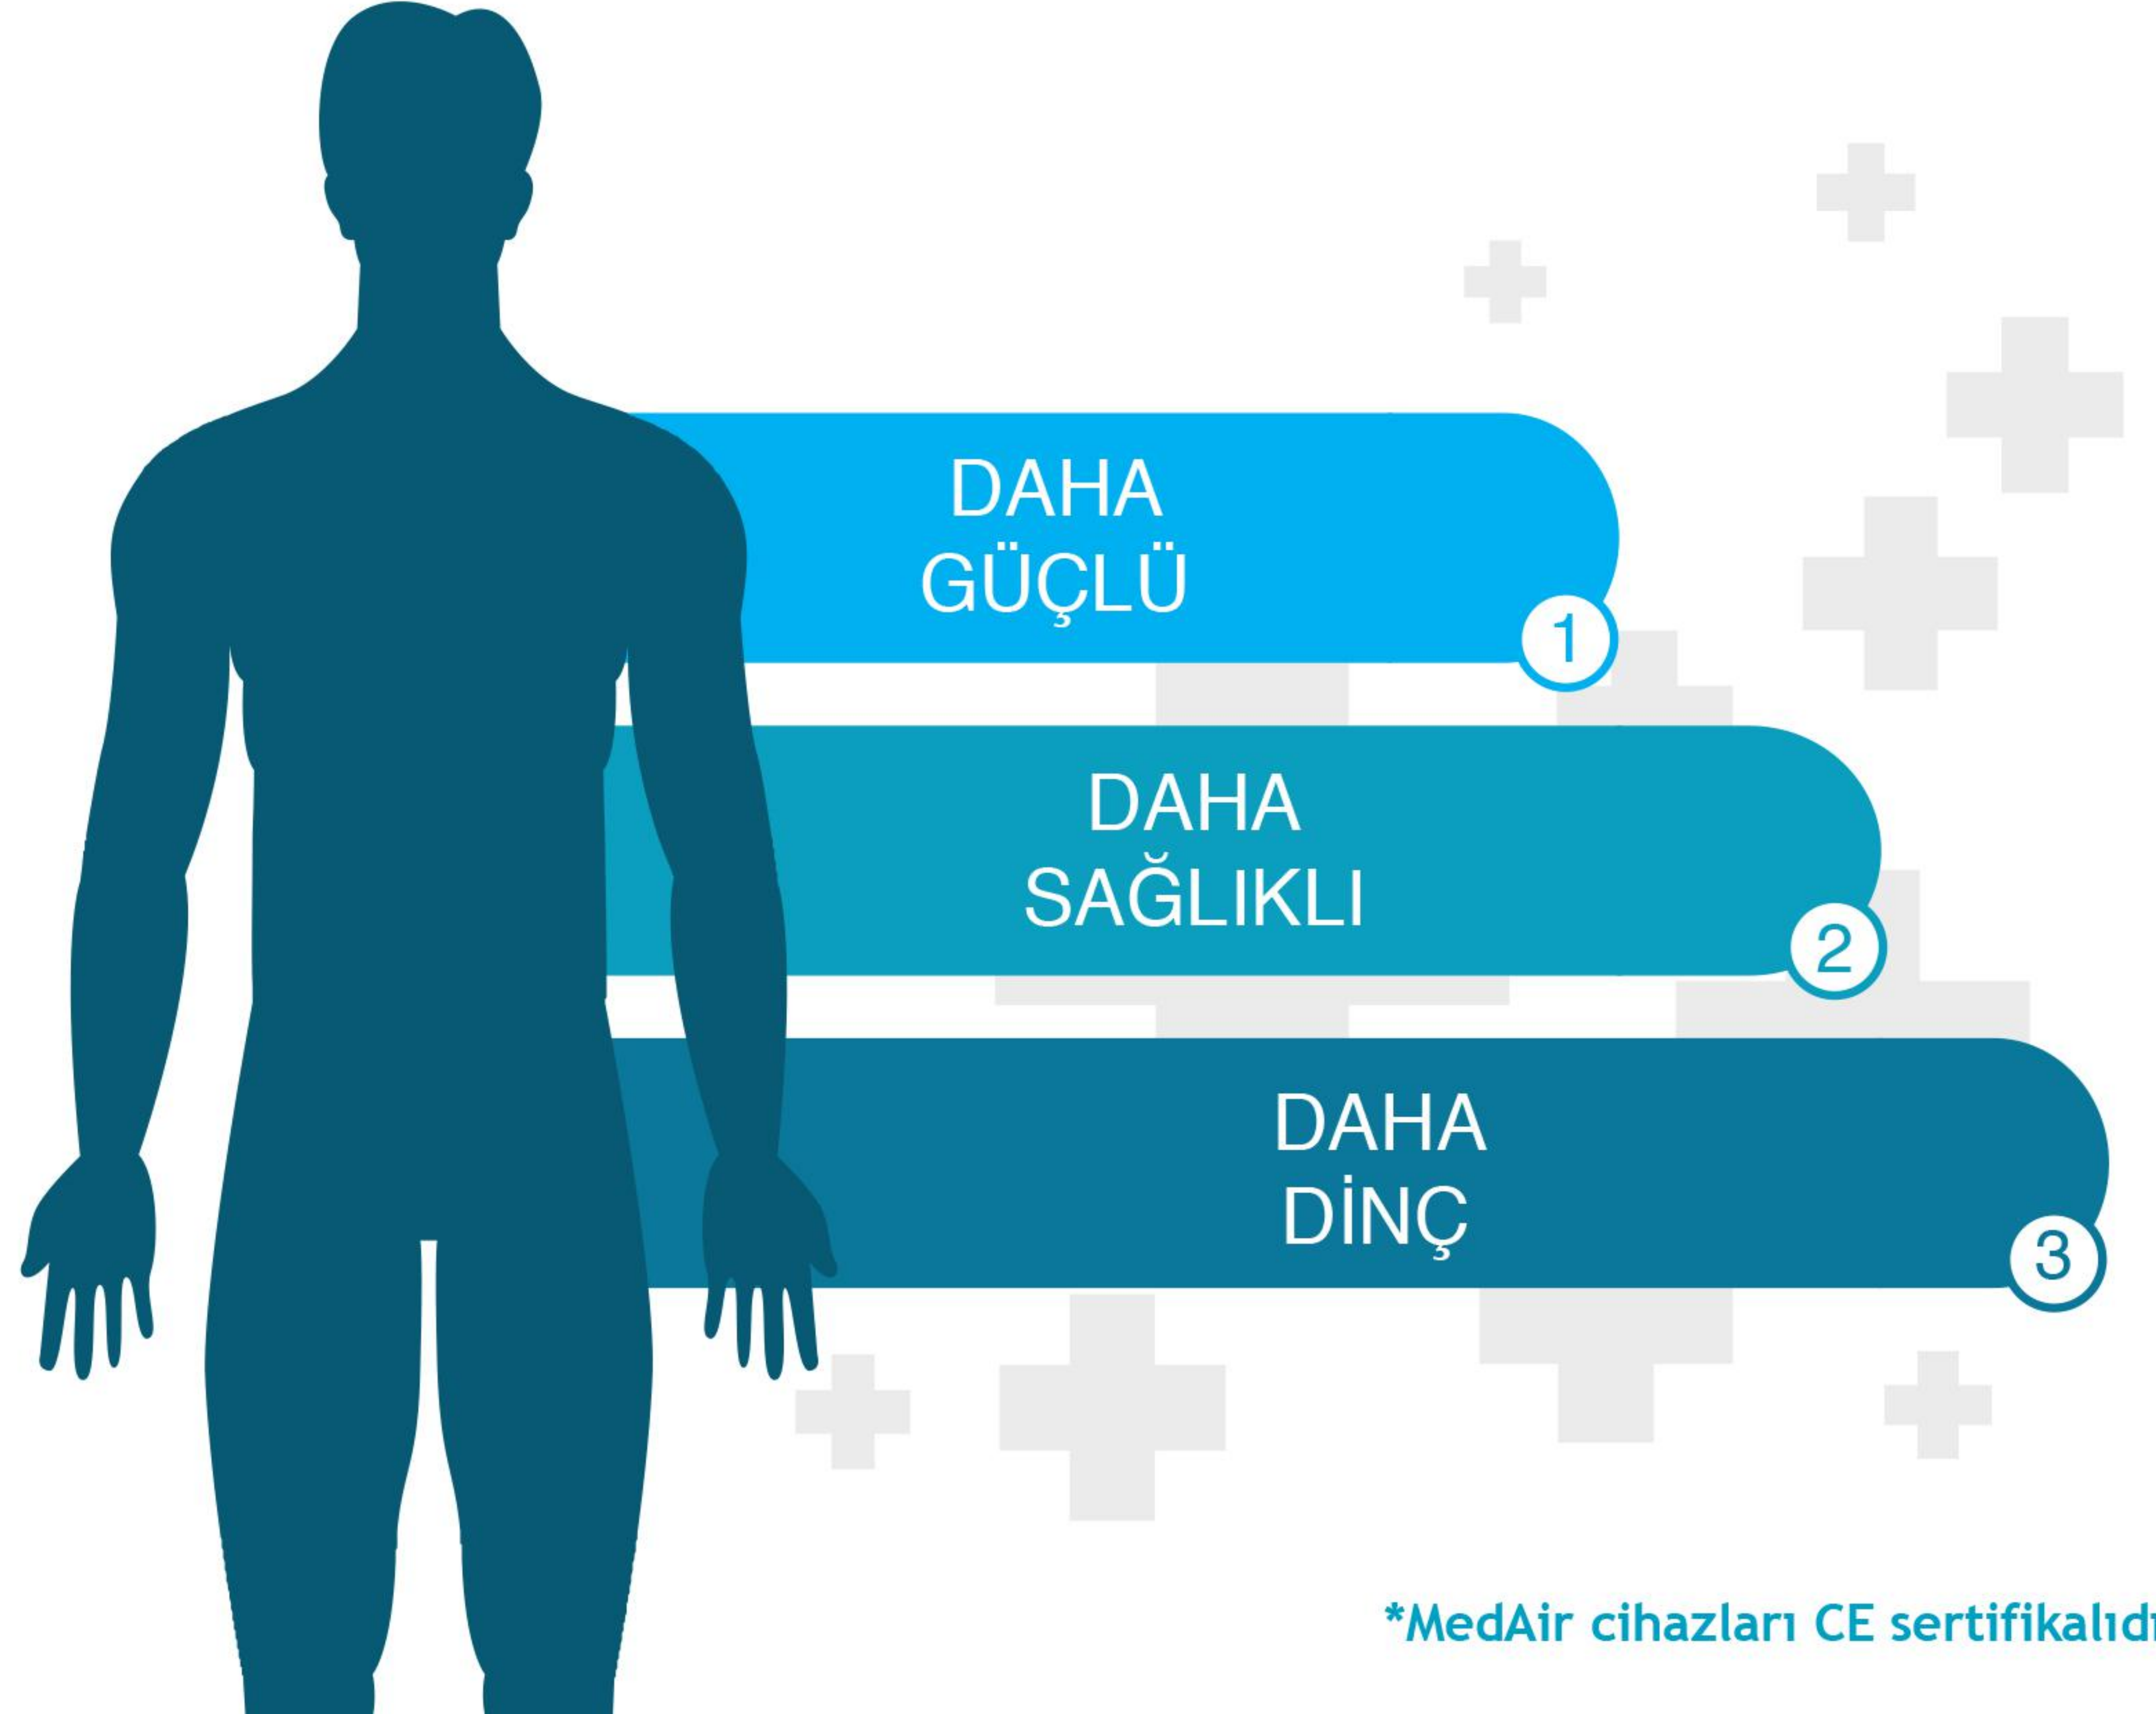

MedAir





# MedAir



## İDDİA EDİYORUZ!



**Daha güçlüsü ve daha sessizi yok.**


MedAir, mekanınızın görünümü ve hissine farklılık katar. MedAir cihazının sahip olduğu konfigürasyonu, her biri kendi alanında uzman olan çok değerli tıp bilim insanlarının görüşleri ve ihtiyaçları değerlendirilmek suretiyle oluşturulmuştur. Bu şekilde konfigürasyonu oluşturulan cihazlarımız yine bilim insanlarımızın bizzat kendileri tarafından test edilmiş ve gerekli onay alındıktan sonra üretilmiştir. Bir beşik yanında veya makam odanız ya da ofisinizde... MedAir cihazları varlığını yalnızca soluduğunuz hava kalitesiyle hissettirir.

\*MedAir cihazları CE sertifikalıdır.






Pm 2.5

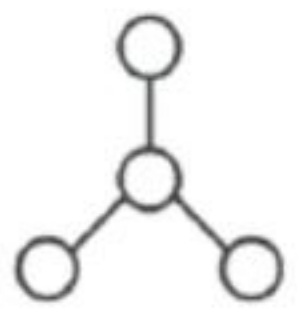

Formaldehit



Koku

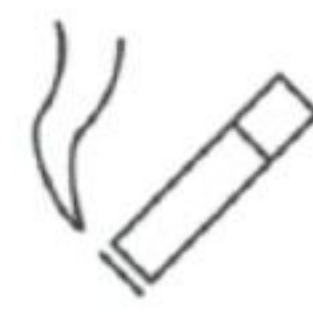

Duman



Zararlı Benzen

## MedAir - 74

MedAir-74 virüs, bakteri ve diğer alerjenlere karşı ofis, araç ve tüm kapalı mekanlarda size %99,97 koruma sağlar. Ar-Ge ekibimiz tarafından virüs ve bakterilere karşı teknolojinin son ürünü olan filtre sistemleri taşınabilir olarak yeniden dizayn edildi. En gelişmiş hava filtreleme ve dezenfektasyon cihazlarında olan her şey MedAir-74'te sizin için bir araya geldi.

SAĞLIKLI YAŞAM SAĞLIKLI  
NEFES İLE BAŞLAR!






# PROFESYONEL HAVA TEMİZLEME VE DEZENFEKTASYON SÜRECİ




Hızlı temizleme için  
türbin vantilatör



Kolay sökülebilir  
takılabilir parçalar

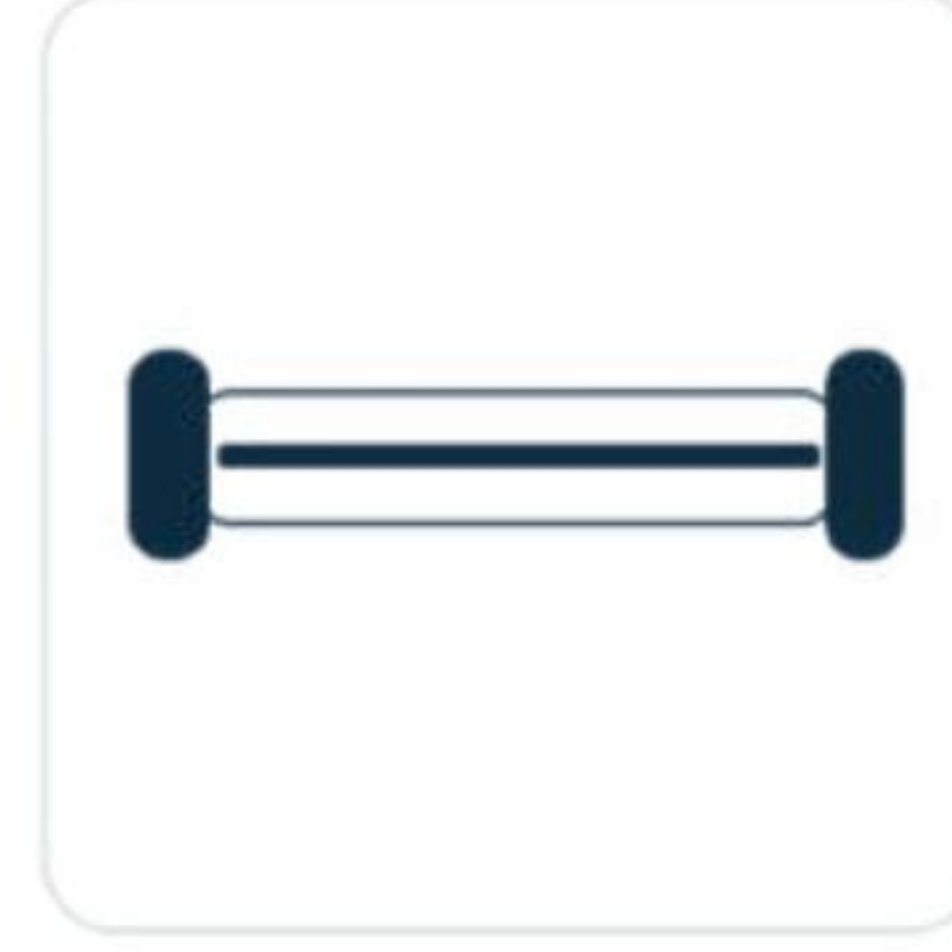

UV Lamba (Led)  
ile etkili sterilizasyon

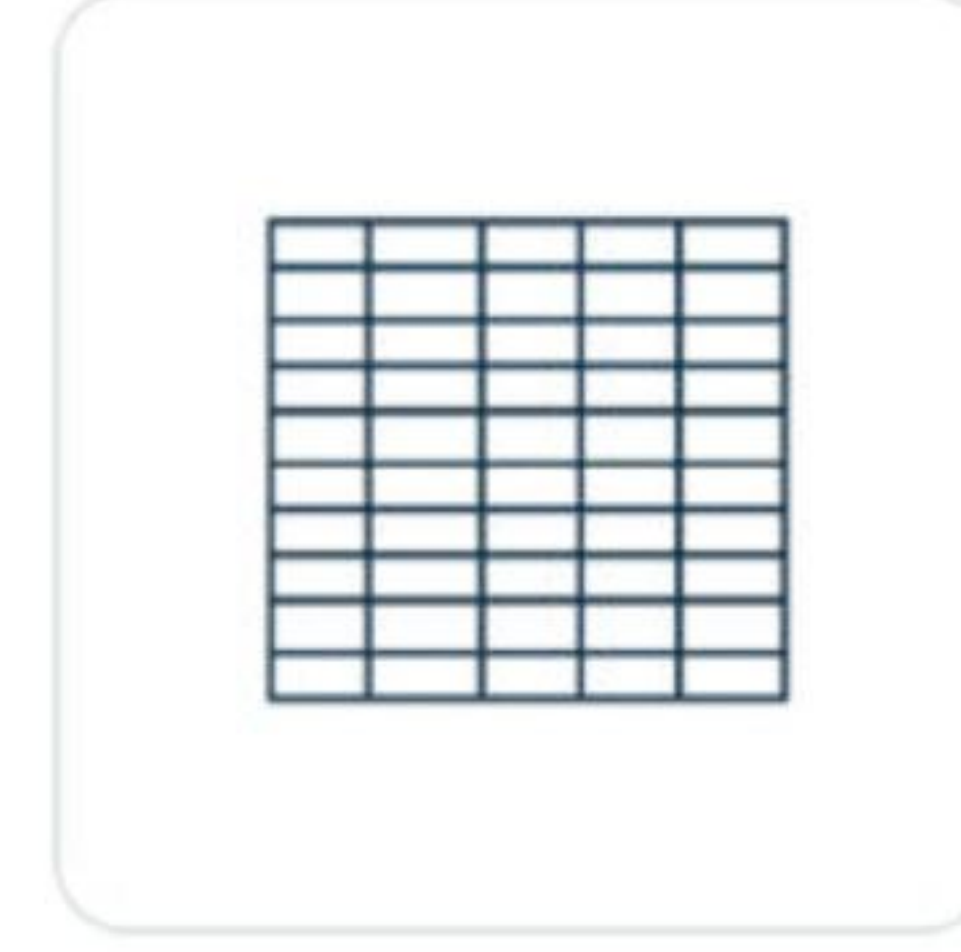

Dönüştürülebilir  
malzeme



Çok fonksiyonlu  
filtreler



Yerleşik aroma terapi  
ünitesi



Yerleşik konsantrasyonlu  
iyon jeneratörü



Formaldehit ve toluen  
yok edici


 selectronik

 MedAir


\*MedAir cihazları CE sertifikalıdır.




# MEDAIR 74'Ü FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

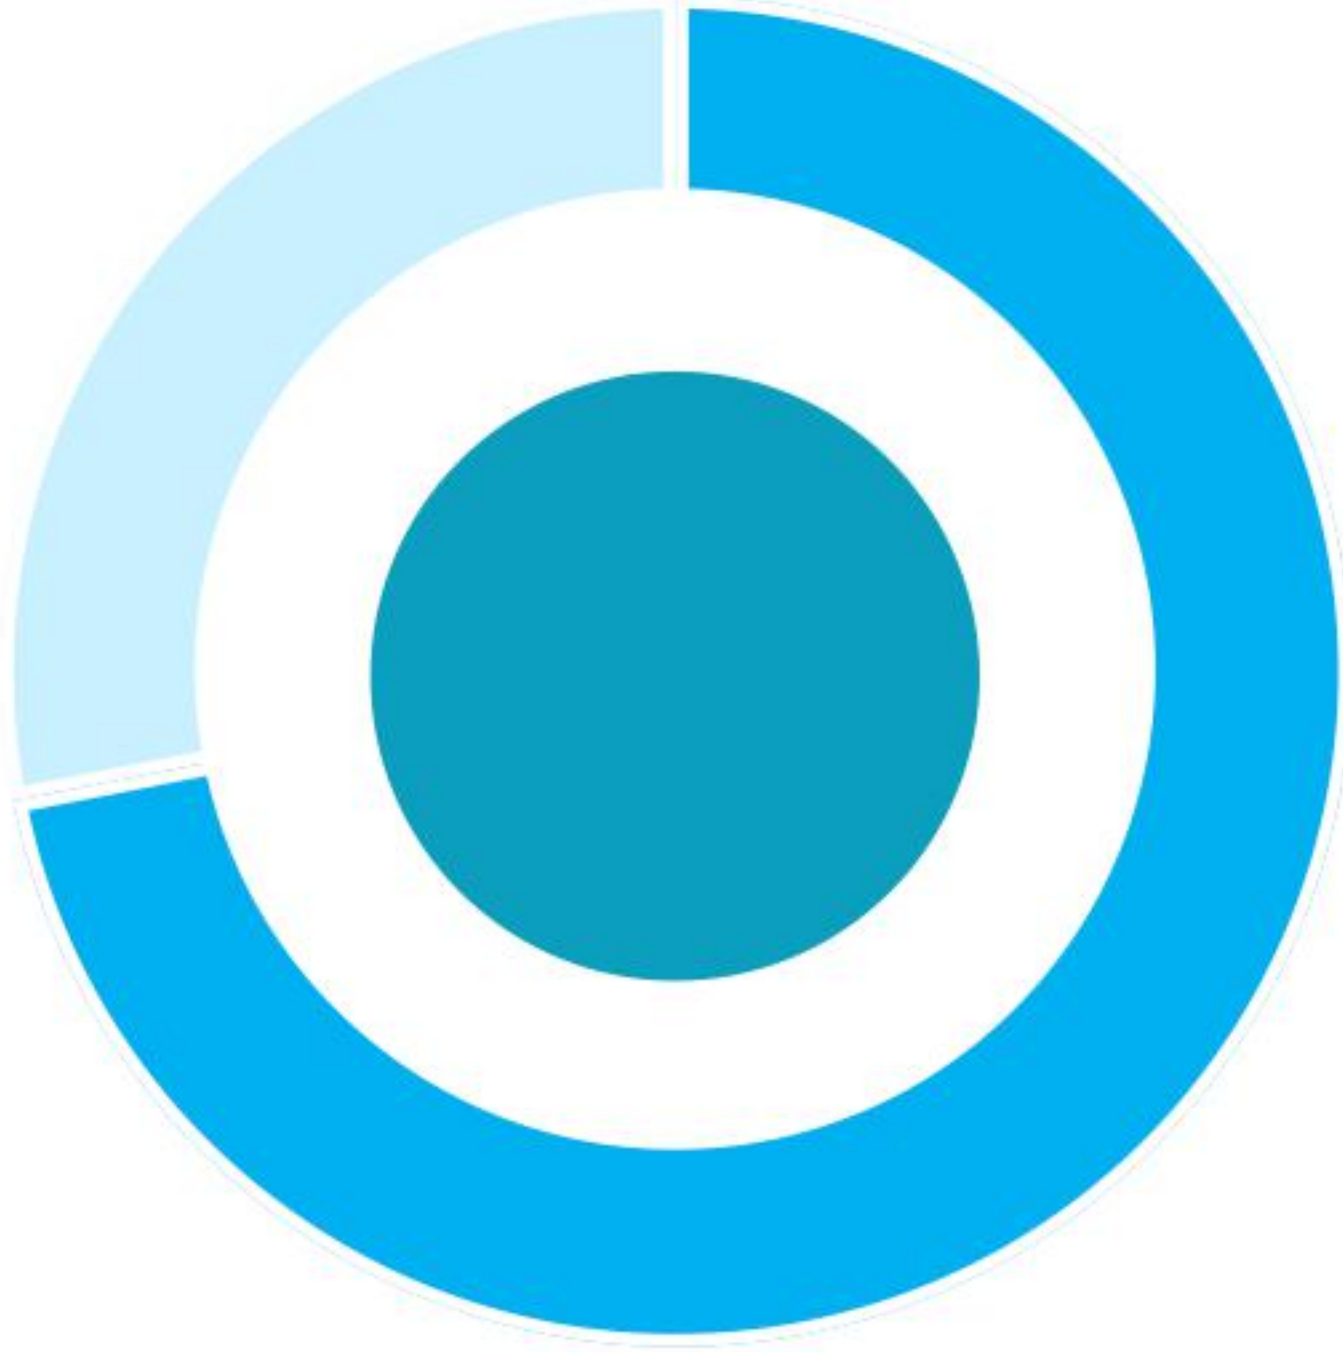


ÇOKLU  
FİLTRELEME  
SİSTEMİ

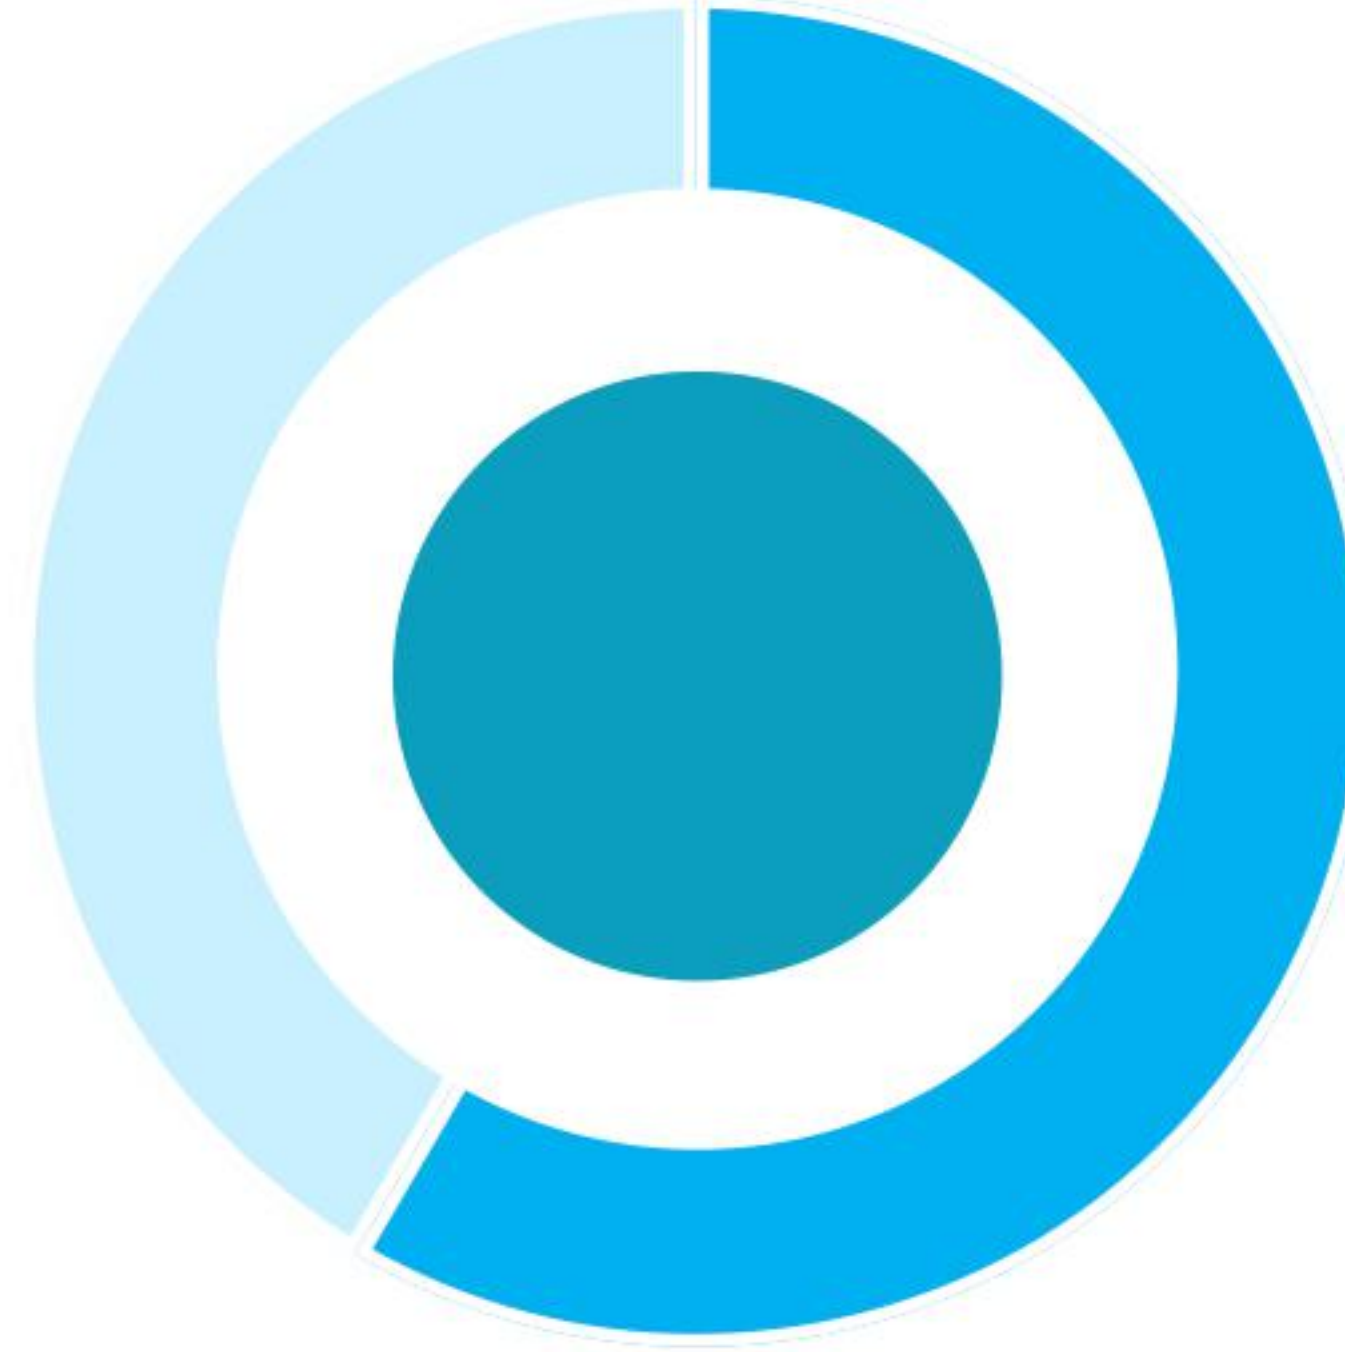

ÇİFT KATMANLI  
KOMPOZİT FİLTRE

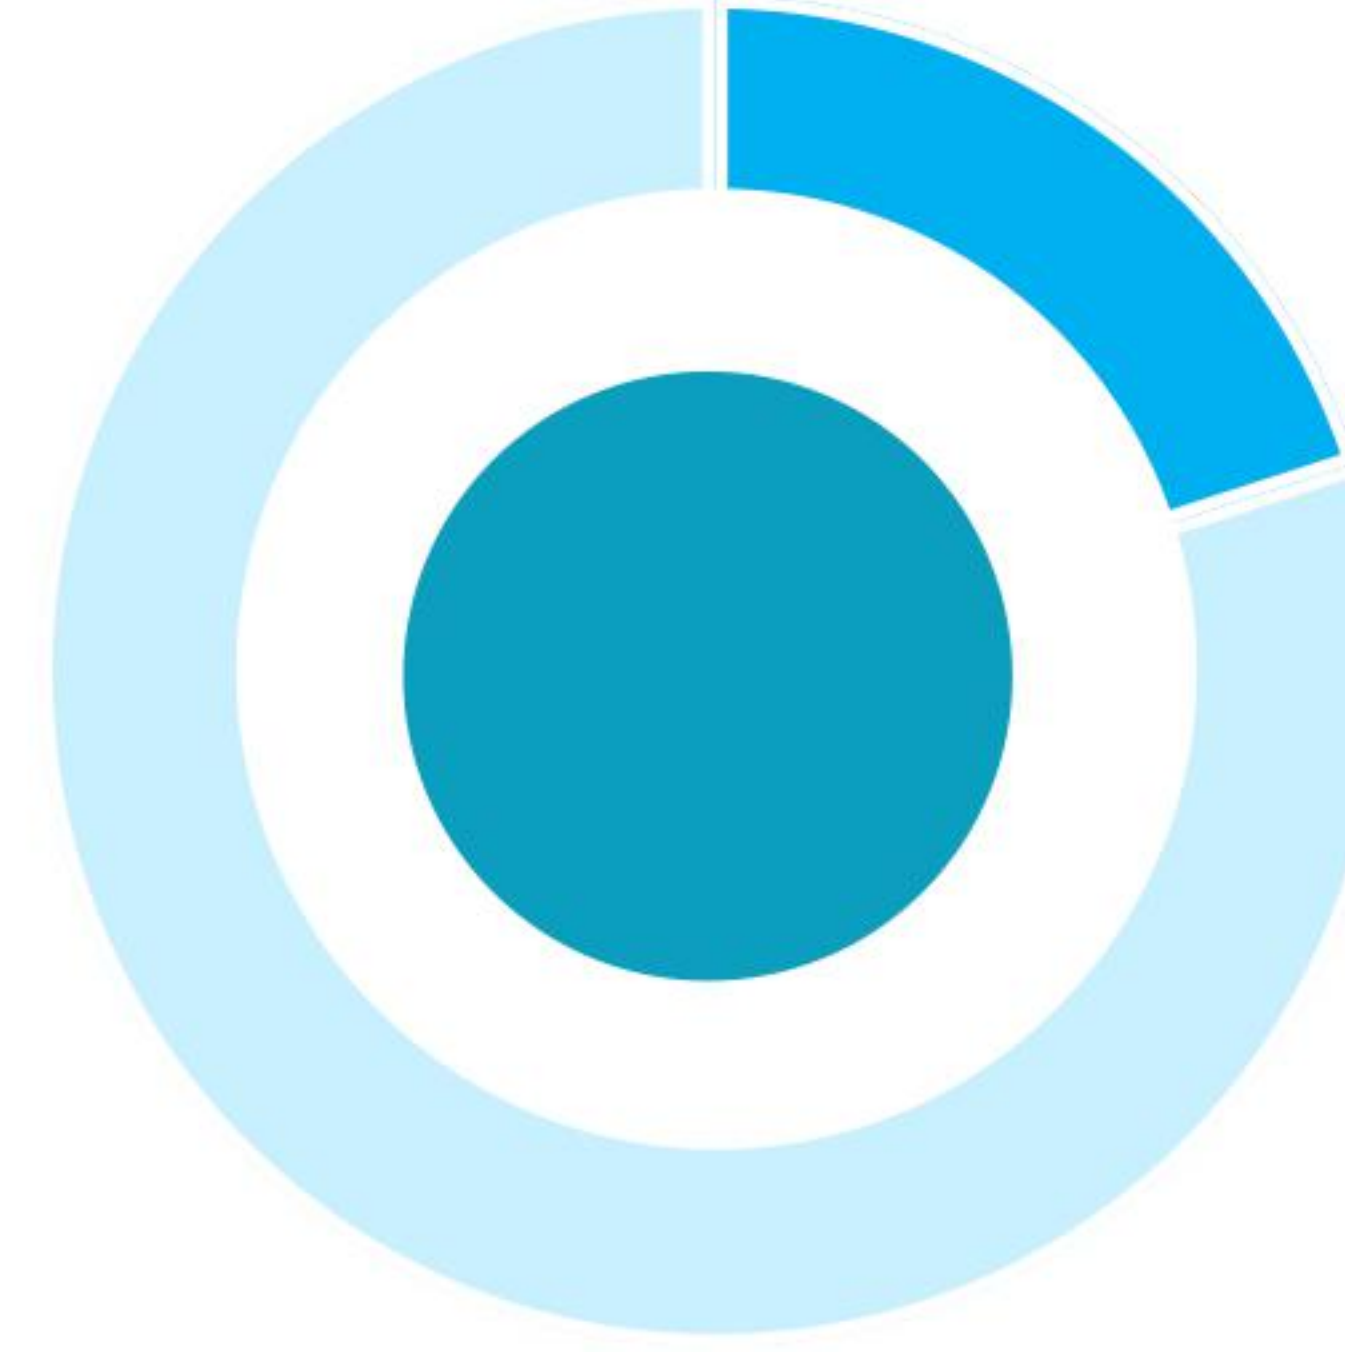

DAHİLİ  
UV LAMBA

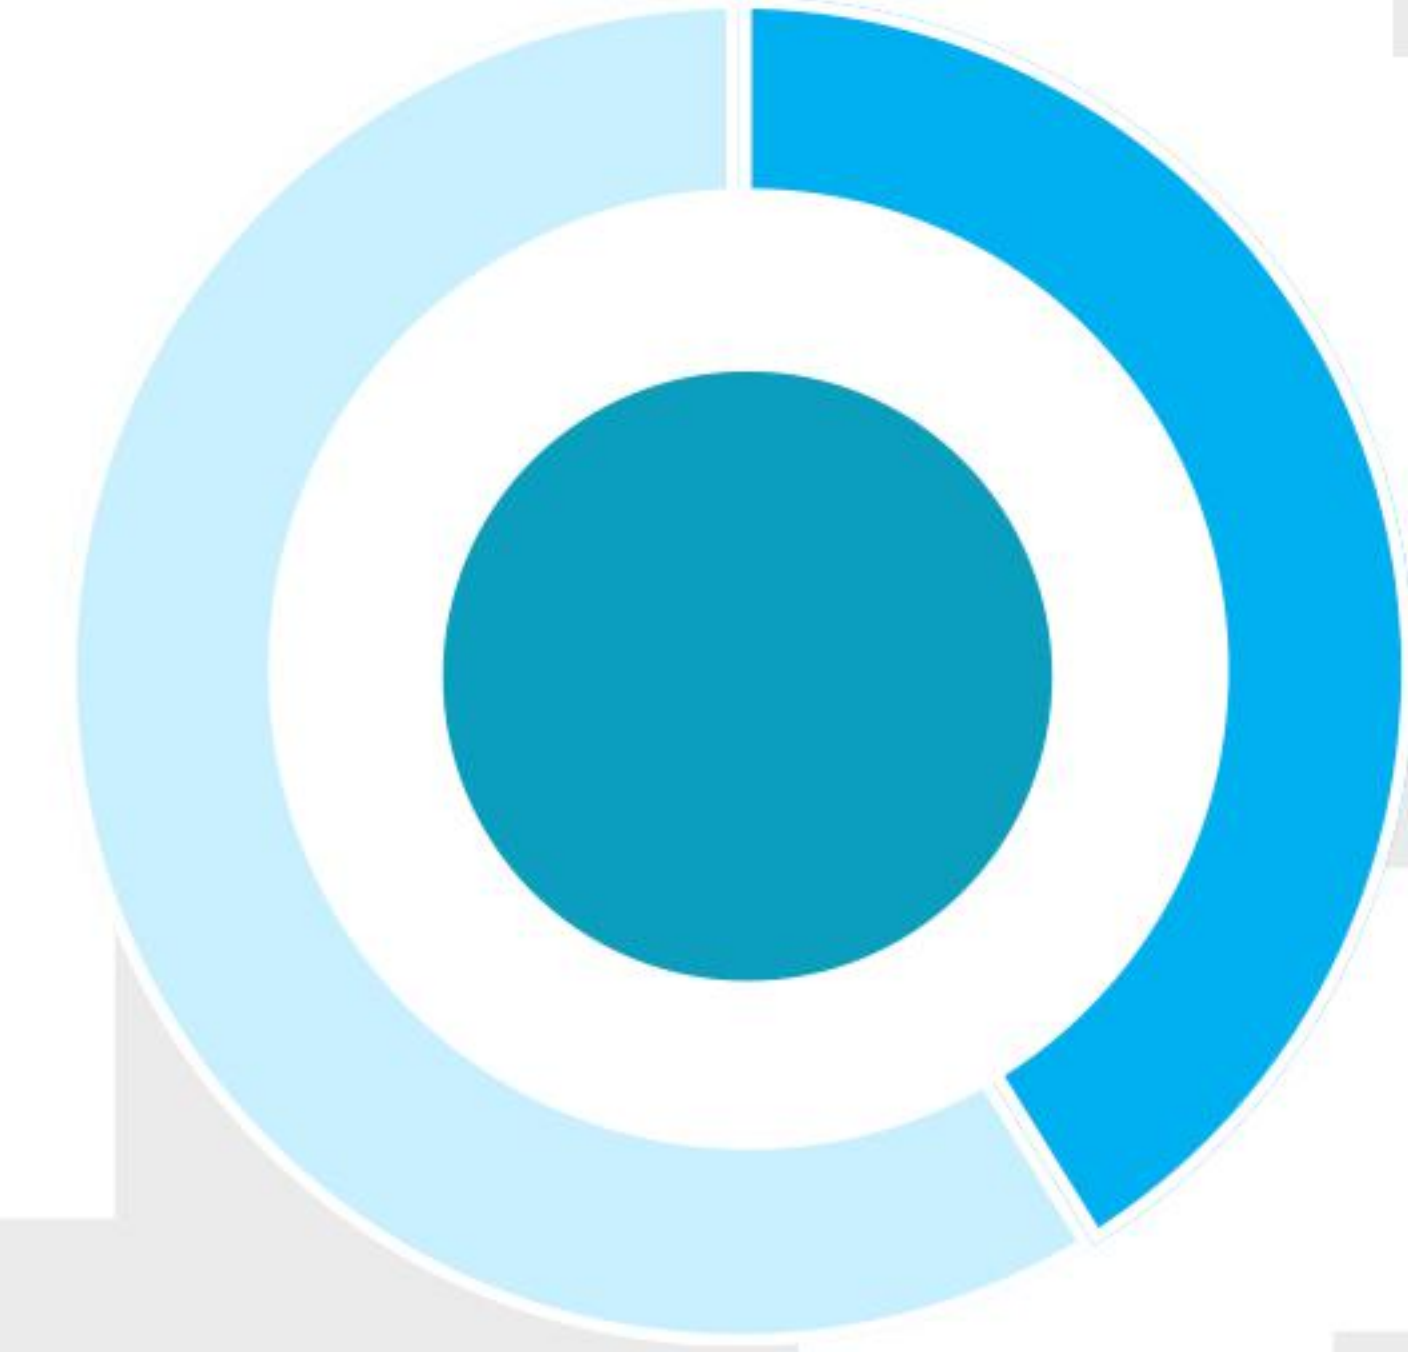

İYON  
JENERATÖRÜ



MedAir 74, sahip olduđu iyon jeneratörü sayesinde kesintisiz bir uyku sağlar.

 selectronik

 MedAir

\*MedAir cihazları CE sertifikalıdır.



## MedAir-13 ELV

İstatistiklere göre, bir kişi günde 2 ile 4 kez asansöre biniyor. Asansörler ise dar ve kapalı olduğundan böyle bir dönemde en riskli alanlardan biri haline geliyor.

MedAir-13 ELV ultraviyole + fotokatalitik nano TiO<sub>2</sub> sterilizasyon teknolojisiyle bakteri, virüs ve zararlı tüm alerjenleri ve aerosolleri ortadan kaldırmak için HEPA yüksek verimli filtreyle iş birliği yapıyor; fotokatalitik nano TiO<sub>2</sub>, 253.7nm dalga boyuna sahip ultraviyolenin ışınlanması altında katalitik bir etki üretiyor. Böylece çevredeki oksijen ve su molekülleri aktif OH<sup>-</sup> ve O<sub>2</sub> serbest iyonik gruplara ayrılıyor. Bu serbest radikaller formaldehit, benzen, etilen, amonyak, TVOC ve diğer kirleticiler ayrıştırıyor ve etkisiz hale getiriyor.



**EN RİSKLİ BÖLGELERDE  
TEMİZ HAVA GÜVENCESİ**







# MedAir-13 Bus Modeli

Hava temizleme ve dezenfektasyon cihazlarımıza entegre edilen UVC filtre + HEPA filtre + Cold catalyst filtre ve iyon jeneratörü ile araç içinde yolcularınızı virüs ve bakteri tehlikesinden koruyoruz. Bir aracın ya da asansörün dezenfekte edilmesi durumunda kişilerin mekandan virüs kapma riskini kaldırıyor olsanızda o araca binen herhangi bir virüs taşıyıp kişi ile aynı havayı soluyan diğer kişileri koruyamazsınız. MedAir 13 bus cihazı, araç içindeki havanın anlık dezenfektasyonu için sizin en güçlü yardımcınızdır.









# SERTİFİKALAR





"TERCÜMEDİR"

GZF20-011497-01

Tarih: 13 Ağustos 2020

Numune Tanımı:

Örnek No.	SGS Numune Kimlik	Tanım
1	GZF20-011497.001	Ekipman

**TEST SONUCU/SONUÇLARI:**

Hava virüsü eliminasyon etkisi\*

Test Yöntemi: Dezenfeksiyon için teknik standartlar (2002 Çin Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 2.1.4.)'a bakınız.

Virüs ve konak hücre	Faaliyet süresi	Seri numarası	Hava virüsü içeriği (TCID <sub>50</sub> /M <sup>3</sup> )	Öldürme oranı (%)
H1N1 Influenza A virüsü (A/PR/8/34) Konak hücre: MDCK	0 ( CK )	1	1.73 X 10 <sup>6</sup>	-
		2	1.44 X 10 <sup>6</sup>	-
		3	1.44 X 10 <sup>6</sup>	-
	1 saat	1	6.58 X 10 <sup>3</sup>	99.17
		2	4.06 X 10 <sup>3</sup>	99.34
		3	4.88 X 10 <sup>3</sup>	99.28

**Notlar:**

1. Mikroorganizmaların havadaki doğal çürümesi elimine edilmiştir.
2. \*Test, yetkin olarak değerlendirilen harici bir laboratuvar tarafından yürütülmüştür.

**KENBİL TERCÜME**  
 Yapılan bu çevirinin  
 aslına uygun olarak tarafından yapıldığını beyan  
 ederim  
 14.08.2020  
 Yeminli Tercüman  
 Burcu Bal

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch  
 Sayfa 2/3

/Mühür/  
 SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.  
 Guangzhou Şubesi Test Merkezi Tanım ve Gıda Laboratuvarı

Aktif yazılı olarak kabul edilmediği, bu belge Şirket tarafından, sayfanın arkasında yerli, talep edildiğinde <http://www.sgs.com.cn/Terms-and-Conditions.aspx> adresinde ulaşılabilir olan Genel Hizmet Koşullarına tabii olarak ve elektronik formatta belgeler için <http://www.sgs.com.cn/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx> adresindeki Elektronik Belgelere dair Kopya ve Hükümlere tabii olarak hazırlanmıştır. Bunlarda tanımlanan sorumluluk, tescim ve yapı koşullarına aynen dikkat çekilir. Bu belgenin herhangi bir sahifeye, buradaki bilgilerin sadece Şirketin mülkiyetinde olan belgeleri yansıtmaya ve varsa diğer belgelerin tasviratlarına aynen içinde olması tavsiye edilir. Şirketin tek sorumluluğu Müşteriye kopya ve bu belge tarafları, işleri belgeleri uyarınca tüm haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirme işlemlerinde muaf tutmasıdır. Bu belge, Şirketin de yazılı onayı olmadan tamamen çoğaltılamaz. Bu belgenin içeriği ve görünümünde yapılan izlenim herhangi bir değişiklik, zahtıca veya telifat yazıya aykırıdır ve sorumluları hakkında yapılacak tarama uyarınca dava açılabılır. Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda gösterilen sonuçlar sadece test edilen numuneye/numunelere aittir.

Dikkat: Test/Teftiş raporu & sertifikasyon gerektirilen kontrol etmek için, lütfen bizimle şu telefon numarası: (86-755) 8307 1443, veya e-mail [CS.Doccheck@sgs.com](mailto:CS.Doccheck@sgs.com) yoluyla iletişime geçin.

No.158 Kezhu Road, Sclertech Park, Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, Çin 510663 1430-681-0488 / (86-20) 82075027  
[www.sgs.com.cn](http://www.sgs.com.cn)

SGS Grup Üyesi (SGS SA)




"TERCÜMEDİR"

GZF20-011497-01

Tarih: 13 Ağustos 2020

Numune fotoğrafı:

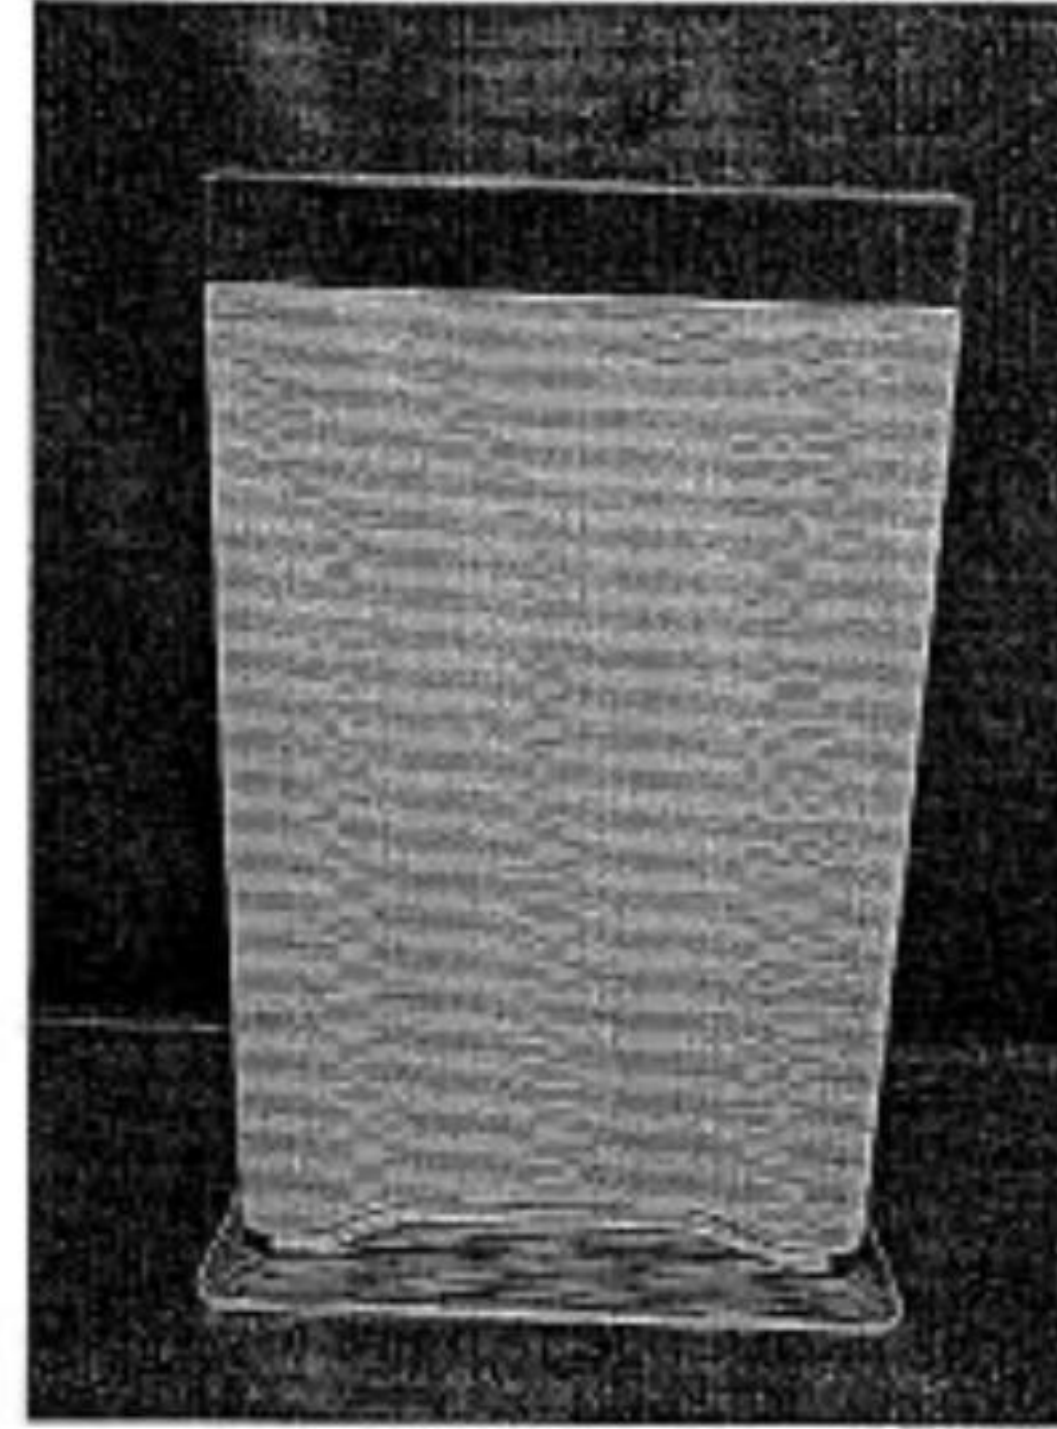

GZF20-011497.001

SGS, fotoğrafın doğruluğunu sadece raporun aslında onaylamaktadır.

\*\*Son\*\*

**KENBİL TERCÜME**  
 Yapılan bu çevirinin  
 aslına uygun olarak tarafından yapıldığını beyan  
 ederim  
 14.08.2020  
 Yeminli Tercüman  
 Burcu Bal

SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd. Guangzhou Branch  
 Sayfa 3/3

/Mühür/  
 SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd.  
 Guangzhou Şubesi Test Merkezi Tanım ve Gıda Laboratuvarı

Aktif yazılı olarak kabul edilmediği, bu belge Şirket tarafından, sayfanın arkasında yerli, talep edildiğinde <http://www.sgs.com.cn/Terms-and-Conditions.aspx> adresinde ulaşılabilir olan Genel Hizmet Koşullarına tabii olarak ve elektronik formatta belgeler için <http://www.sgs.com.cn/Terms-and-Conditions/Terms-and-Conditions.aspx> adresindeki Elektronik Belgelere dair Kopya ve Hükümlere tabii olarak hazırlanmıştır. Bunlarda tanımlanan sorumluluk, tescim ve yapı koşullarına aynen dikkat çekilir. Bu belgenin herhangi bir sahifeye, buradaki bilgilerin sadece Şirketin mülkiyetinde olan belgeleri yansıtmaya ve varsa diğer belgelerin tasviratlarına aynen içinde olması tavsiye edilir. Şirketin tek sorumluluğu Müşteriye kopya ve bu belge tarafları, işleri belgeleri uyarınca tüm haklarını ve yükümlülüklerini yerine getirme işlemlerinde muaf tutmasıdır. Bu belge, Şirketin de yazılı onayı olmadan tamamen çoğaltılamaz. Bu belgenin içeriği ve görünümünde yapılan izlenim herhangi bir değişiklik, zahtıca veya telifat yazıya aykırıdır ve sorumluları hakkında yapılacak tarama uyarınca dava açılabılır. Aksi belirtilmedikçe, bu test raporunda gösterilen sonuçlar sadece test edilen numuneye/numunelere aittir.

Dikkat: Test/Teftiş raporu & sertifikasyon gerektirilen kontrol etmek için, lütfen bizimle şu telefon numarası: (86-755) 8307 1443, veya e-mail [CS.Doccheck@sgs.com](mailto:CS.Doccheck@sgs.com) yoluyla iletişime geçin.

No.158 Kezhu Road, Sclertech Park, Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, Çin 510663 1430-681-0488 / (86-20) 82075027  
[www.sgs.com.cn](http://www.sgs.com.cn)

SGS Grup Üyesi (SGS SA)

MedAir

Virüs etkinlik Raporları SGS \* yurt dışı laboratuvarlarından alınmıştır.

\*SGS, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ve denetim, doğrulama, test ve belgelendirme hizmetleri sunan çok uluslu bir İsviçre şirkettir. 89.000'den fazla çalışanı vardır ve dünya çapında 2.600'den fazla ofis ve laboratuvar işletmektedir. Forbes Global 2000'de 2015, 2016 ve 2017'de yer almış, saygınlığı uluslararası platformlarca kabul görmüştür.





## Sample Description:

Specimen No.	SGS Sample ID	Description
1	GZF20-011497.001	Equipment

## TEST RESULT(S):

Air virus elimination effect\*

Test Method: Refer to *Technical standard for disinfection (2002)* Ministry of health of the people's republic of China 2.1.3

Virus and host cell	Action Time	Serial Number	Air virus content (TCID <sub>50</sub> /m <sup>3</sup> )	Killing rate (%)
H1N1 Influenza A virus (A/PR/8/34) Host cell: MDCK	0 (CK)	1	1.73×10 <sup>5</sup>	-
		2	1.44×10 <sup>5</sup>	-
		3	1.44×10 <sup>5</sup>	-
	1h	1	6.58×10 <sup>3</sup>	99.17
		2	4.06×10 <sup>3</sup>	99.34
		3	4.88×10 <sup>3</sup>	99.28

## Remark:

1. The natural decay of the microorganisms in the air had been eliminated.
2. \*The test was carried out by external laboratory assessed as competent.



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic formal documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing (inspection) report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8387 1443, or email: CN.DocuCheck@sgs.com  
No. 118 Kefu Road, Satech Park, Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 | 400-891-3488 | (86-20) 82075027 | www.sgs.com  
中国·广州·经济技术开发区科学城科珠路118号 邮编: 510663 | 400-891-3488 | (86-20) 82075027 \* sgs.china@sgs.com

## Sample photo:



GZF20-011497.001

SGS authenticate the photo on original report only  
\*\*\* End \*\*\*



Unless otherwise agreed in writing, this document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx> and, for electronic formal documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Documents.aspx>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law. Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested.

Attention: To check the authenticity of testing (inspection) report & certificate, please contact us at telephone: (86-755) 8387 1443, or email: CN.DocuCheck@sgs.com  
No. 118 Kefu Road, Satech Park, Guangzhou Economic & Technology Development District, Guangzhou, China 510663 | 400-891-3488 | (86-20) 82075027 | www.sgs.com  
中国·广州·经济技术开发区科学城科珠路118号 邮编: 510663 | 400-891-3488 | (86-20) 82075027 \* sgs.china@sgs.com

Virüs etkinlik Raporları SGS \* yurt dışı laboratuvarlarından alınmıştır.

\*SGS, merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan ve denetim, doğrulama, test ve belgelendirme hizmetleri sunan çok uluslu bir İsviçre şirkettir. 89.000'den fazla çalışanı vardır ve dünya çapında 2.600'den fazla ofis ve laboratuvar işletmektedir. Forbes Global 2000'de 2015, 2016 ve 2017'de yer almış, saygınlığı uluslararası platformlarca kabul görmüştür.



# REFERANSLAR



## KİŞİLER

- Prof. Dr. Tülay OKMAN KILIÇ - Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
- Prof. Dr. Orhan Tarçın - Gastroenterolog
- Prof. Dr. Gülden Paşaoğlu KARAKIŞ -Göğüs Hastalıkları Uzmanı
- Prof. Dr. Özay ORAL - Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı
- Uzm. Dr. Müjgan Oral Kahyaoğlu- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
- Prof. Dr. Gökhan KIRBAŞ - Göğüs hastalıkları Uzmanı
- Doç. Dr. Selma ÖZBİLGİN-Psikiyatrist
- Cihan UÇAR - Plastik Estetik Cerrah
- Dr. Mustafa KALAYCI -İş yeri hekimi
- Prof. Dr. Aziz ŞATANA Kayseri Üniv . Ziraat Fakültesi
- Elif UZUN - Diş Hekimi
- Emine EZA - Diş Hekimi
- Tuğba DUYMAZ- Diş Hekimi
- Gürhan KIRBAŞ- Diş Hekimi
- Şerif Ali KARANFİL - Düzce Veteriner Oda Başkanı
- Mithat HIZLI - SPK üyesi ( eski ) ve Bağımsız denetçi / yeminli mali müşavi
- Hakkı KOŞAR- Türk Karatesinin kurucusu
- İsmail ACAR-Sanatçı / Ressam

## KURUMLAR

- Bağcılar Belediye Başkanlığı
- Bağcılar Belediyesi Başak A.Ş.
- Maya Akar Center İş Merkezi-Şişli
- İSEM OSGB
- Kabataş Erkek Lisesi
- Adıyaman 4.Noter
- Eczaneler
- Veterinerler
- Avukatlar